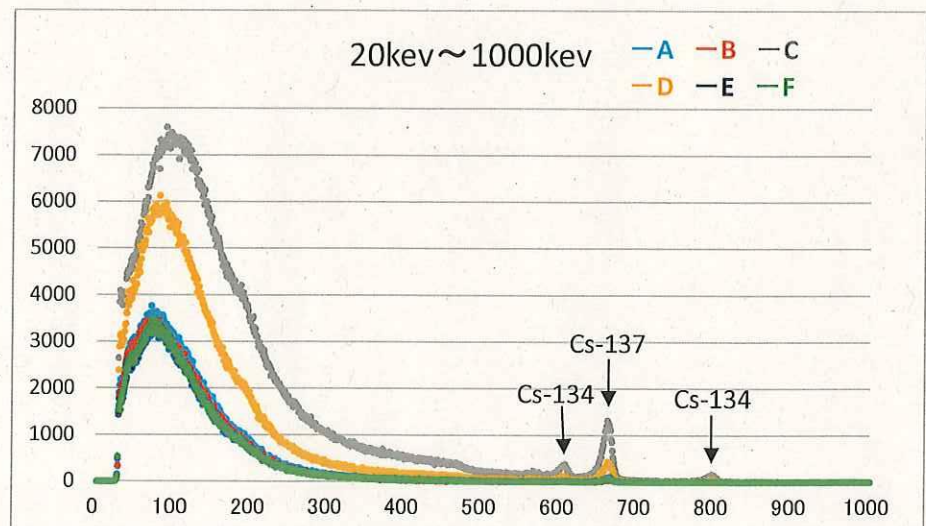
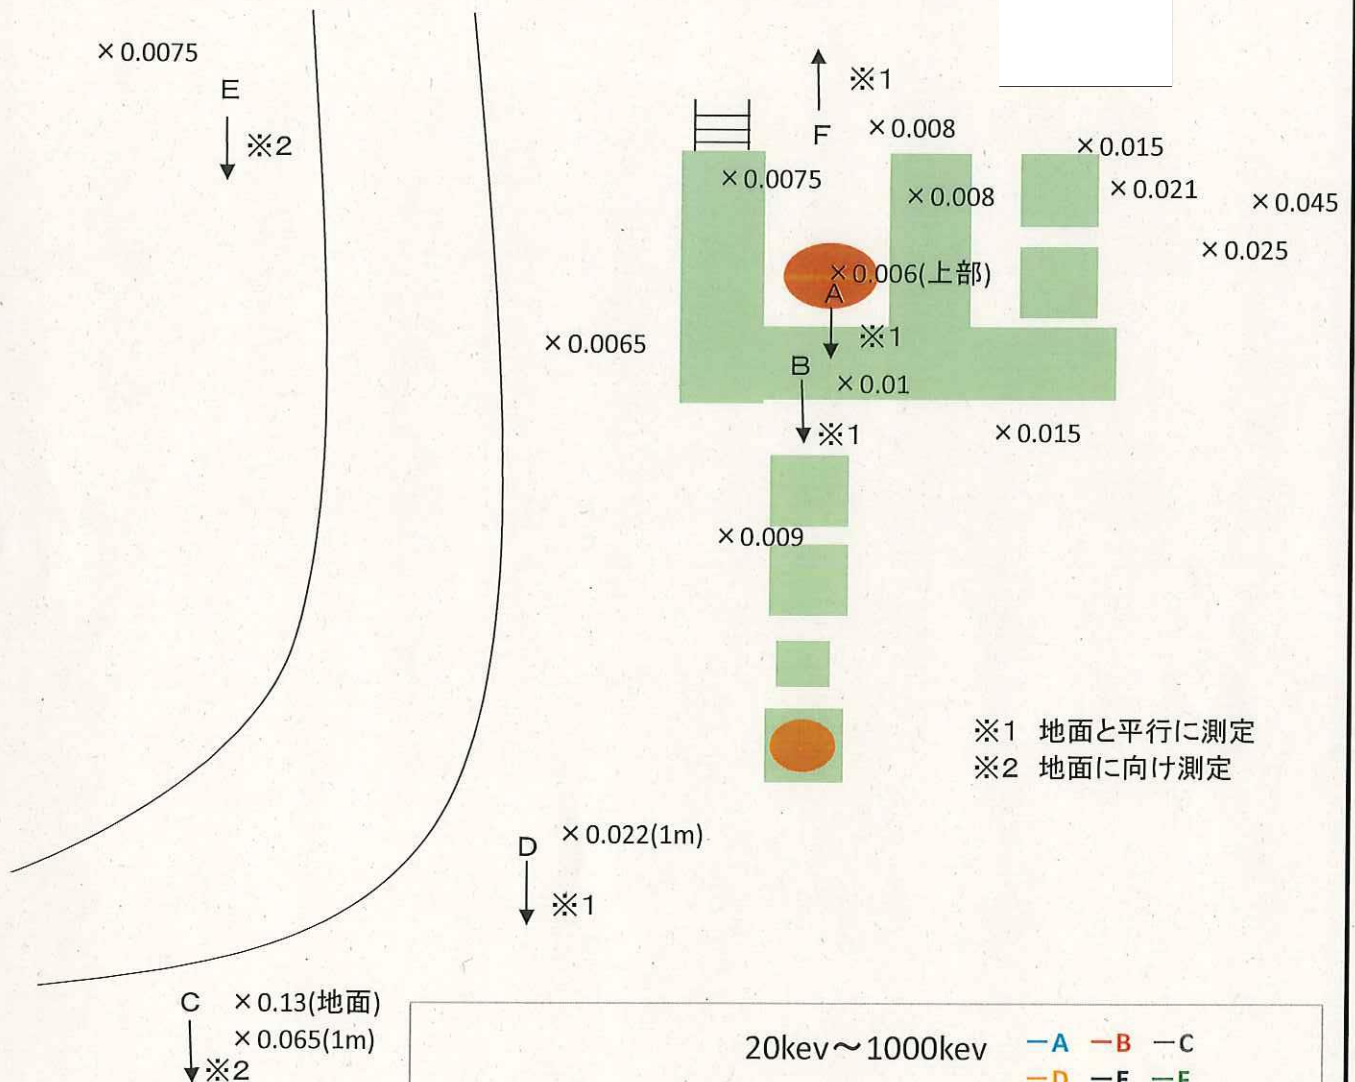


放射線サーベイ記録 1/2

測定目的	PSFモニタ付近 CZTスペクトル測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> GM直接
測定場所	PSFモニタ付近	測定者	
測定日時	2017/5/22	14:00 ~ 15:30	測定器 (機器効率) リーIW-289 F1- γ スペクトル1-1

× : 空間線量率 (mSv/h)

A~F: γ スペクトル測定位置

放射線サーベイ記録 2/2

測定目的	PSFモニタ付近 CZTスペクトル測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> GM直接
測定場所	PSFモニタ付近	測定者	
測定日時	2017/5/22	14:00 ~ 15:30	測定器 リ-ICW-289 F1-γスペクトル1-1

以下参考

